

## レセプトチェッカーLS インストール版 Ver. 1.4.0 S150(build017) リリースノート

この文書は、レセプトチェッカーLSインストール版Ver. 1.4.0 S150導入時の注意事項などについて記載しています。

レセプトチェッカーLSインストール版をご利用の際は必ず目を通していただくようお願いいたします。また、これらの内容はユーザーのフィードバックを受けて更新されることがありますので、随時最新情報をご確認ください（最新情報は [https://receiptcheckerls.info/rn\\_install/](https://receiptcheckerls.info/rn_install/) でご確認ください）。

### 1. 導入についての注意事項

#### 1-1. アップデート適用環境について

レセプトチェッカーLSインストール版 S150更新用Setup.exeを利用される場合は、更新用Setup.exeをダウンロードするためのインターネット環境が必要です。

#### 1-2. インストール方法


##### 【手動更新】

(1) 下記サイトより、レセプトチェッカーLSインストール版更新用Setup.exeをダウンロードします。

レセプトチェッカーLSインストール版最新版のダウンロードサイト

[https://receiptcheckerls.info/ls\\_version/](https://receiptcheckerls.info/ls_version/)

(2) ダウンロードした Setup.exe をダブルクリックで起動します。

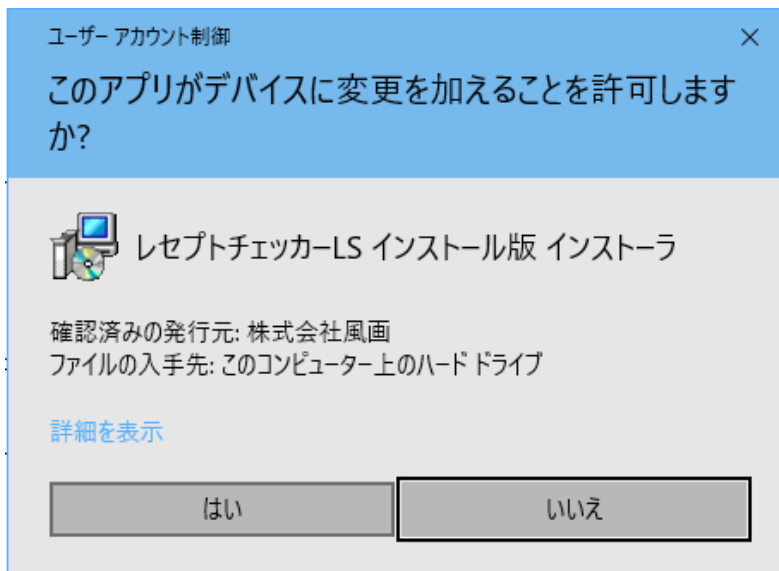

上図の「ユーザーアカウント制御」画面が出たら、「はい(Y)」をクリックして進めます。

「いいえ(N)」をクリックすると終了します。

「レセプトチェッカーLSインストール版 セットアップウイザードの開始」画面が表示された場合は「次へ」をクリックします。

使用許諾契約書の同意についての確認画面が表示されます。スクロールすることで、最後までお読みいただけます。



「同意する」にチェックして「次へ」をクリックします。

「レセプトチェッカー-LS インストール版」のアイコンを作成するので、「デスクトップ上にアイコンを作成する」にチェックをいれて「次へ」をクリックします。




「インストール(I)」をクリックします。



「インストール状況」が表示されます。




「レセプトチェッカーLS インストール版 セットアップウイザードの完了」画面が表示されます。  
「完了」をクリックして終了です。

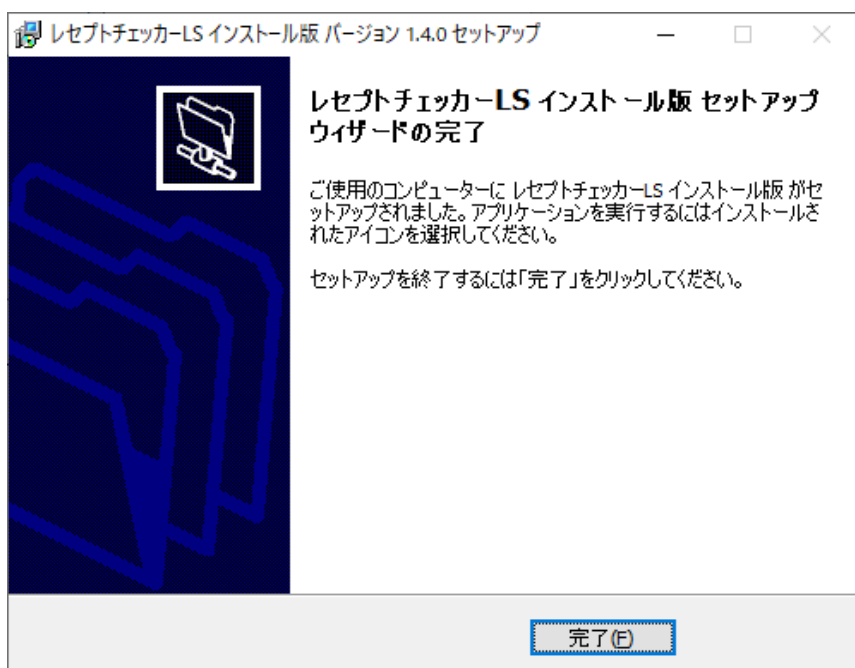

(3) レセプトチェッカーLS インストール版のシステムバージョンは Ver. 1.4.0(build:017) になっております。



(4) システムバージョン以外のバージョン情報は、「システム Ver. 1.4.0(build:017)」と表示されたボタンをクリックすると得ることができます。

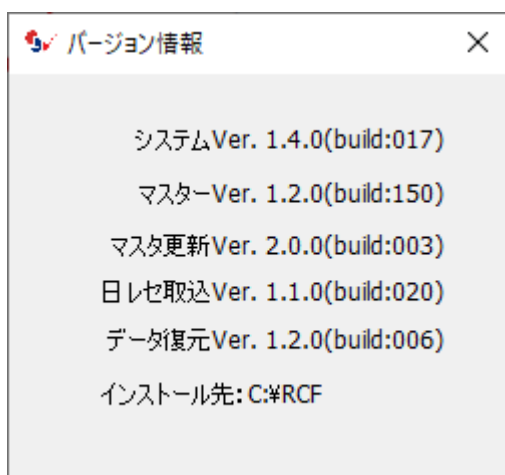

## 【自動更新】

「システムVer. 1. 2. 0(build:005)」以降のバージョン場合は、プログラム更新とマスター更新（診療行為や医薬品追加）の両方の更新がある場合は、左下図のように表示されますので、選択することができます。プログラム更新のみの場合は、左下図のように表示されます。

マスター更新（診療行為や医薬品追加）のみの場合は、「マスター更新の確認」画面は表示されず、自動的に更新されます。

### 【プログラム更新とマスター更新の場合】



### 【プログラム更新のみの場合】



「システムVer. 1. 2. 0(build:005)」以前のバージョンの場合は起動時に自動的にマスター更新のためのインストール用プログラム(Setup.exe)をダウンロードし、自動でインストール開始します。

以下の画面が表示されますが、「はい」をクリックして進めます。

「レセプトチェッカーFUGA サイトへ」のボタンはプログラム更新後。「レセプトチェッカーLS サイトへ」に変更されます。



上記画面が出ずに、最右下のタスクバーに隠れている場合があります。



その場合は、 をクリックして表示させます。

以降は、【手動更新】の(2)からと同じ展開となります。

## 2. 変更された主な内容

(1) 診療行為（検査）が追加されています。チェックデータの内容も修正しています。

更新された内容は下記を確認ください。

<https://receiptcheckerls.info/mn-s150/>

(2) コメントコード「830189100（撮影部位（CT撮影）（その他））」についてもチェックを行えるようになりました。ただし、以前との整合性のため、チェックを行う場合は「審査対象」にさせていただく必要があります。

### 【操作方法】

- ① 「患者詳細」→「撮影部位（CT撮影）（その他）」をダブルクリックします。
- ② 外来・入院の「審査対象」を「対象」にします。

	診療行為	薬価	HIT	回数	点数
1	再診料	73.0		1	
2	時間外対応加算1	5.0		1	78
3	外来管理加算	52.0		1	52
4	CT撮影(イ、ロ又はハ以外)	560.0		1	560
5	撮影部位(CT撮影)(その他):肝臓				
6	コンピューター断層診断	450.0		1	450

③

→ ダブルクリックします

適応部位確認 X

830189100 撮影部位(CT撮影)(その他):肝臓 閉じる

傷病名	診療開始日	部位チェックデータ
1 COVID-19の疑い	R04.06.01	肝臓
2 急性上気道炎	R04.06.01	
3 インフルエンザの疑い	R04.06.01	
4 RSウイルス感染症	R04.11.21	
5 肝臓紫斑病	R05.02.19	

HITデータ  
肝臓

HIT病名  
肝臓紫斑病

除去 変更 追加

外来 <input checked="" type="radio"/> 対象 <input type="radio"/> 対象外	入院 <input checked="" type="radio"/> 対象 <input type="radio"/> 対象外
--	--

審査対象にします

### 3. 不具合対応

- (1) プログラム更新はありません。