

レセプトチェッカーACE Ver. 1.5.0 S193(build014) リリースノート

この文書は、レセプトチェッカーACE安定版Ver. 1.5.0 S193導入時の注意事項などについて記載しています。

レセプトチェッカーACEをご利用の際は必ず目を通していただくようお願いいたします。

また、これらの内容はユーザーのフィードバックを受けて更新されることがありますので、随時最新情報をご確認ください（最新情報は https://receiptcheckera.jp/rn_install/ でご確認くださいませ）。

1. 導入についての注意事項

1-1. アップデート適用環境について

レセプトチェッカーACE S193更新用Setup.exeを利用される場合は、更新用Setup.exeをダウンロードするためのインターネット環境が必要です。

1-2. インストール方法


【手動更新】

(1) 下記サイトより、S193 更新用 Setup.exe をダウンロードします。

レセプトチェッカーACE 最新版のダウンロードサイト

<https://receiptcheckera.jp/data/Ace/Setup.exe>

(2) ダウンロードした Setup.exe をダブルクリックで起動します。


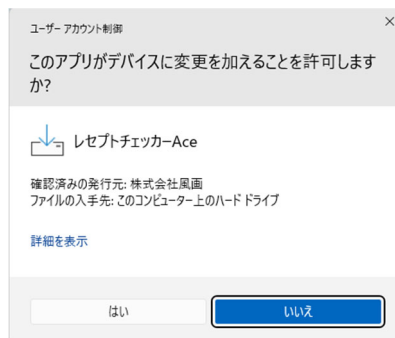


上図の「ユーザーアカウント制御」画面が出たら、「はい(Y)」をクリックして進めます。

「いいえ(N)」をクリックすると終了します。


「レセプトチェッカーACE セットアップウィザードが開始します。」「レセプトチェッカーACE セットアップウィザードの開始」画面が表示されたら「次へ」をクリックします。

使用許諾契約書の同意についての確認画面が表示されます。スクロールすることで、最後までお読みいただけます。

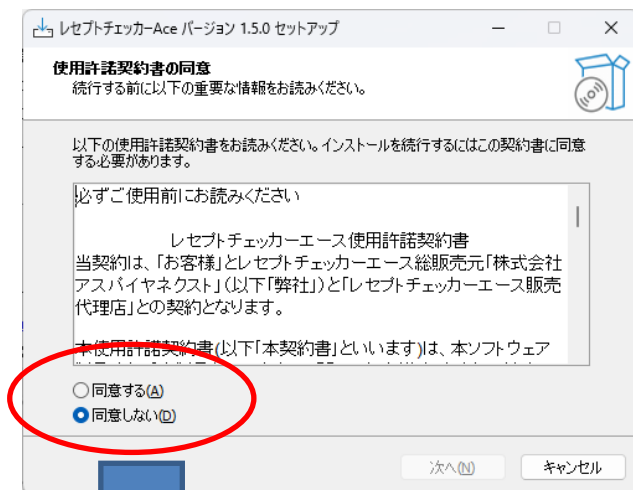


「同意する」にチェックして「次へ」をクリックします。

「インストール(I)」をクリックします。

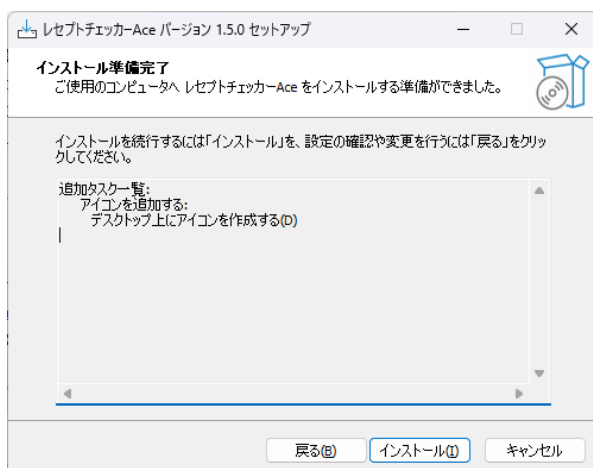


「インストール状況」が表示されます。

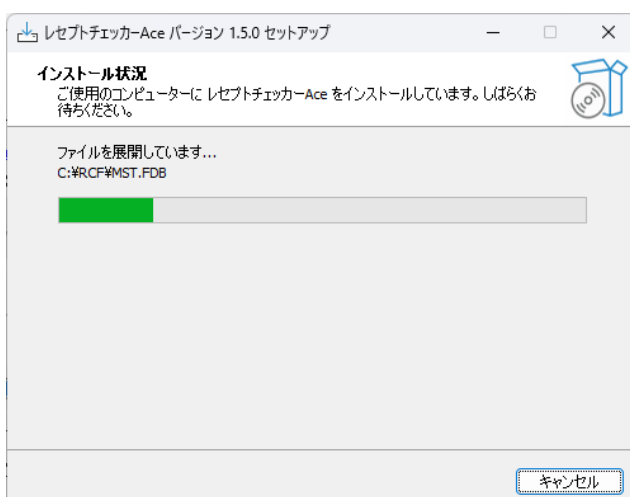


「レセプトチェッカーAce セットアップウィザードの完了」画面が表示されます。


「完了」をクリックして終了です。

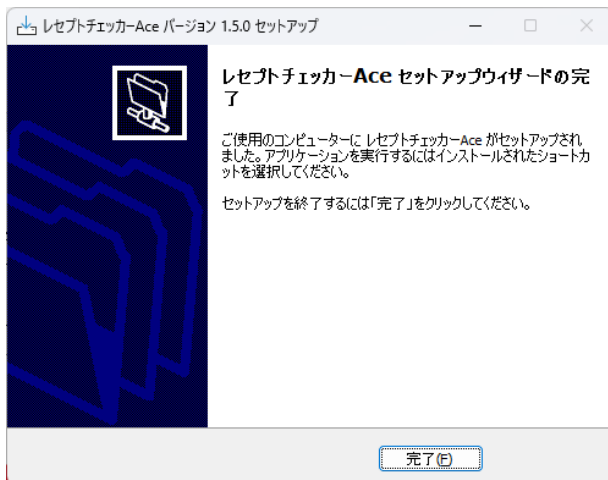

(3) システムバージョンは Ver. 1.5.0(build:014) になっています。

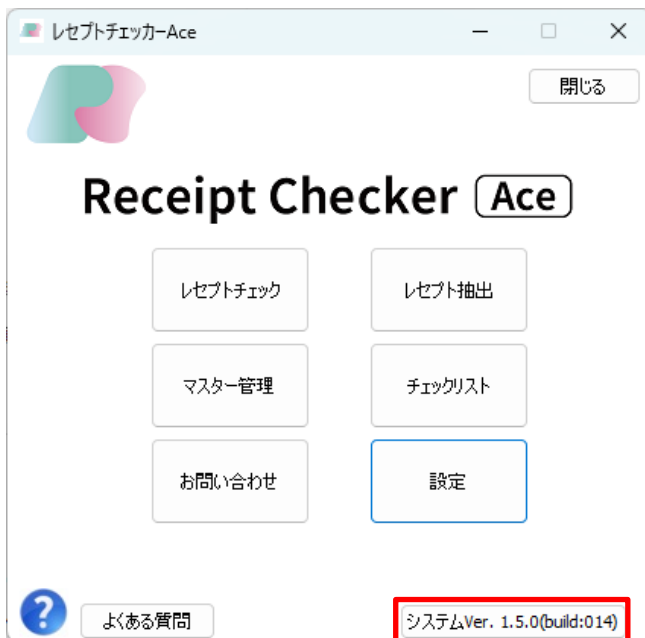

(4) システムバージョン以外のバージョン情報は、「システム Ver. 1.5.0(build:014)」と表示されたボタンをクリックすると得ることができます。

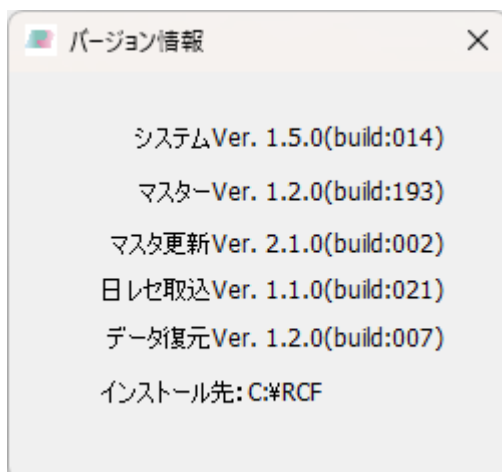

2. 変更された主な内容

- (1) レセプト摘要欄チェックで「150412670 高次収差解析加算（水晶体再建術（眼内レンズ・縫着レンズ挿入））」がコメントコード必須から外しました。

詳しくは下記を確認ください。

<https://receiptcheckera.jp/mn-s193/>

3. 不具合対応

レセプトチェック設定の「レセプトチェック機能設定」画面で、「湿布薬をチェックする」にチェックを入れても保存されない不具合を改修しました。