

レセプトチェッカーACE Ver. 1.5.0 S196(build015) リリースノート

この文書は、レセプトチェッカーACE安定版Ver. 1.5.0 S196導入時の注意事項などについて記載しています。

レセプトチェッカーACEをご利用の際は必ず目を通していただくようお願いいたします。

また、これらの内容はユーザーのフィードバックを受けて更新されることがありますので、随時最新情報をご確認ください（最新情報は https://receiptcheckera.jp/rn_install2/ でご確認いただけます）。

1. 導入についての注意事項

1-1. アップデート適用環境について

レセプトチェッカーACE S196更新用Setup.exeを利用される場合は、更新用Setup.exeをダウンロードするためのインターネット環境が必要です。

1-2. インストール方法


【手動更新】

(1) 下記サイトより、S196 更新用 Setup.exe をダウンロードします。

レセプトチェッcker ACE 最新版のダウンロードサイト

<https://receiptcheckera.jp/data/Ace/Setup.exe>

(2) ダウンロードした Setup.exe をダブルクリックで起動します。

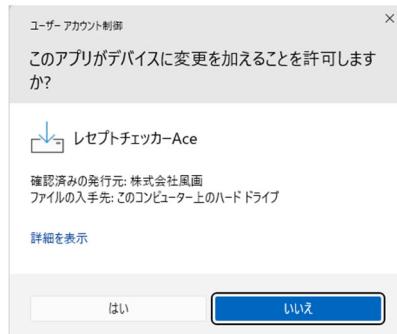


上図の「ユーザー アカウント制御」画面が出たら、「はい(Y)」をクリックして進めます。

「いいえ(N)」をクリックすると終了します。


「レセプトチェッcker ACE セットアップ ウィザード」が開始します。「レセプトチェッcker ACE セットアップ ウィザードの開始」画面が表示されたら「次へ」をクリックします。

使用許諾契約書の同意についての確認画面が表示されます。スクロールすることで、最後までお読みいただけます。

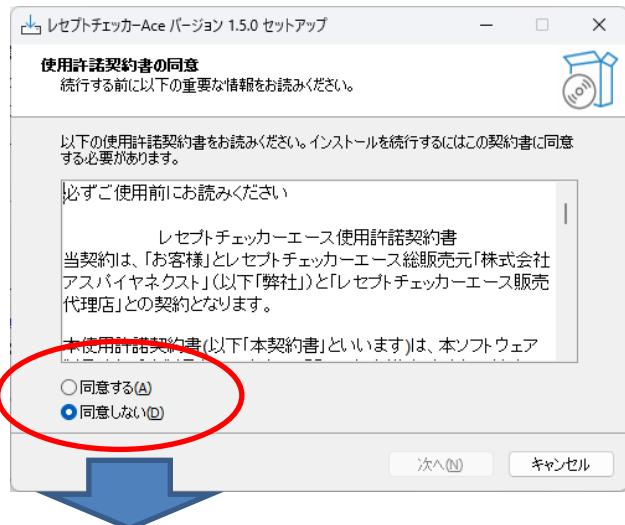


- 同意する(A)
- 同意しない(D)

「同意する」にチェックして「次へ」をクリックします。

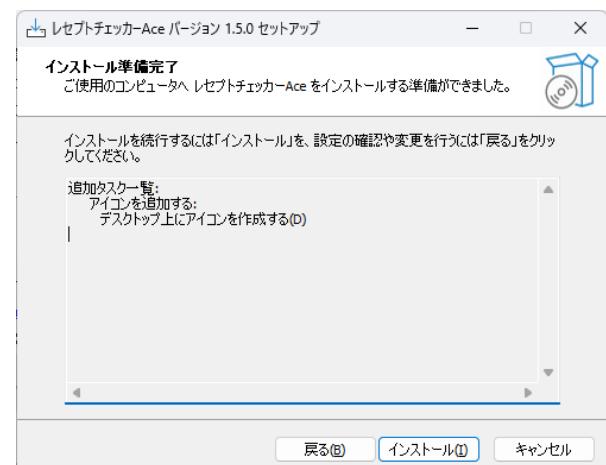


「インストール(I)」をクリックします。

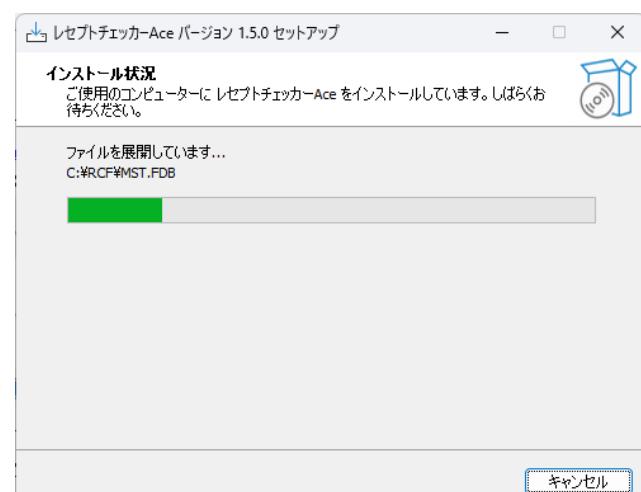

「レセプトチェック Ace セットアップ ウィザードの完了」画面が表示されます。


「完了」をクリックして終了です。

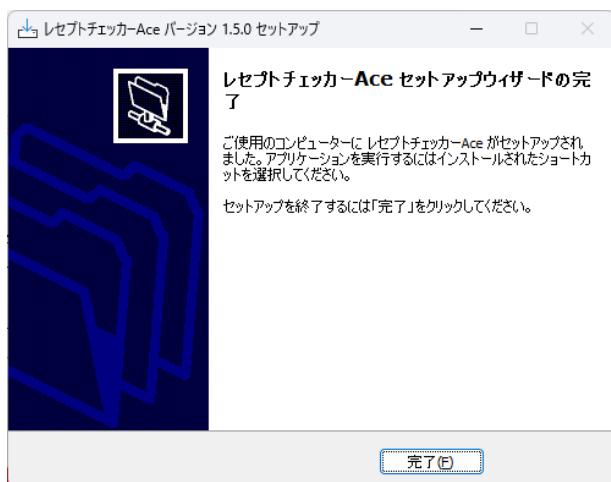

(3) システムバージョンは Ver. 1.5.0(build:015) のままです。



(4) システムバージョン以外のバージョン情報は、「システム Ver. 1.5.0(build:015)」と表示されたボタンをクリックすると得ることができます。

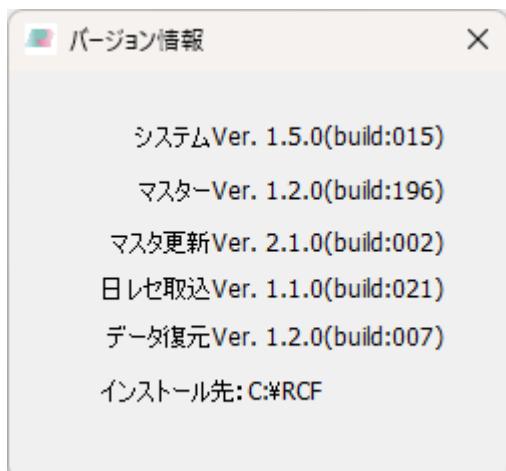

2. 変更された主な内容

(1) 検査、手術、医薬品、特定器材の追加があります。

更新された内容は下記を確認ください。

https://receiptcheckera.jp/rn_install2/

(2) 特定疾患処方管理加算対象の外用薬について、見直しました。詳しくは下記をご参照ください。

<https://receiptcheckera.jp/Ace/Data/202251209.zip> (zip形式)

(3) 以下の診療行為は、条件を見直した結果、レセプトコメントコード必須対象から外しました。

診療行為コード	診療行為名	対象コメントコード
114041210	在宅持続陽圧呼吸療法治療機 器加算（ASVを使用）	820100127 ア 留意事項通知アの慢性心不全患者にAS V療法を実施した場合
		820100128 イ 留意事項通知イの心不全患者にAS V療 法を実施した場合

(4) 以下の医薬品のチェックデータに誤りがありましたので変更しました。

医薬品コード 医薬品名

629934601 プラリアH I 皮下注 60mg シリンジ0.5mL

3. 不具合対応

- ①プログラムの修正はありません。